

2017 年医用设备购置项目东院区妇科设备 P

招标文件信息

项目编号： GMDL2020166100

项目名称： 2017 年医用设备购置项目东院区妇科
设备 P

包 号： A

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法（新价格分算法）

资格性审查表

| 序号 | 内容 |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》"投标人资格要求"）； |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质。 |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 出现将一个包或一个标段中的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一货物投标时，提供两套或以上的投标方案(招标文件规定允许有替代方案情况除外)； |
| 3 | 投标总价或分项报价超出财政预算限额的； |
| 4 | 同一项目出现两个或以上报价，且根据招标文件通用条款“34.2 算术错误将按以下方法更正”内容，无法确定有效报价的； |
| 5 | 未按招标文件附件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件（投标文件组成不完整）； |
| 6 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据招标文件注明的不允许偏离的实质性要求和条件来做出评判）； |
| 7 | 投标文件载明的交货期未满足招标文件规定的期限； |
| 8 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的； |
| 9 | 《技术规格偏离表》、《免费保修期内售后服务条款偏离表》、《免费保修期外售后服务条款偏离表》和《其他商务条款偏离表》填写不全、不实； |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目，或投标报价对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 11 | 投标文件电子文档有病毒； |
| 12 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的； |
| 13 | 选择了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密； |
| 14 | 在同一 IP 地址上传电子投标文件的（由市、各区政府采购中心或中国远东国际招标有限公司为投标人提供辅助上传产生同一 IP 地址的情形除外）； |
| 15 | 法律、法规规定的其他情形。 |

评标信息

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分= $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

F1、F2.....Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重($A1 + A2 + \dots + An = 1$)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 | | | 权重(%) |
|----|------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 价格 | | | 30 |
| 2 | 商务部分 | | | 20 |
| | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
| | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5 | 评审标准：（1）投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。满足免费保修期的得 30 %，每增加一年加 10 %，最高得 60 %；（2）其他要求全部满足要求的得 40%，每负偏离一项扣 10%，扣完为止，可有正偏离但不加分。 |
| | 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 8 | 评审标准：（1）投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣 10%，最多扣 50%，可有正偏离但不加分；（2）投标人应填写价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细，以《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单》为准，各投标人的此项得分按以下公式计算：得分=价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的最低报价/投标人价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的报价×50%。（说明：本评分项总分 100%，以上两项分别占 50 %。） |
| | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 2 | 评审标准： 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足或优于要求的得 100%，每负偏离一项扣 10%。 |
| | 4 | 疫情防控 | 5 | ①投标人纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业(以下简称“重点保障企业”)，直接参与我市政府采购投标的，投标人提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接或名单网页截图或政府部门出具的文件或企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件）扫描 |

| | | | | |
|---|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 件，得 60%；②投标人未裁员或裁员率低于 20%，即 2020 年 3 月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的视为稳岗企业；投标人提供自身符合稳岗企业条件的承诺函（承诺函格式详见招标文件第三章），得 40%；投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。 |
| 3 | 技术部分 | | | 43 |
| | 序号 | 评分因素 | 权重 (%) | 评分准则 |
| | 1 | 技术参数响应情况 | 40 | 评审标准： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行评分，全部满足或优于各项技术参数指标及要求的得 100%，带▲的重要参数条款每负偏离一项扣 10%，其他技术要求每负偏离一项扣 5%，扣完为止，最低 0 分。 |
| | 2 | 技术保障措施 | 3 | 评审标准：在投标文件中详细说明技术保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员等），评审委员会根据响应情况进行评分： 横向比较，技术团队规模和人员充足，技术方案完整详细，具有针对性、可行性、实操性，技术人员的素质高，得 100%；技术团队规模和人员较充足，技术人员素质较高，技术方案结构具体，实施适宜，有较强的条理性，得 80%。技术团队规模和人员基本满足项目需求，技术人员素质一般，技术方案制定完整，具有条理性，部分符合需求书内容，得 60%；技术团队规模和人员不足，技术人员素质较差，技术方案制定内容不完整，得 40%。 |
| 4 | 诚信部分 | | | 7 |
| | 序号 | 评分因素 | 权重 (%) | 评分准则 |
| | 1 | 诚信管理情况 | 5 | 评审标准：根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42 号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采 |

| | | | | |
|--|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
| | 2 | 履约 | 2 | 评审标准：近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心无履约评价为差的记录，本项得 100%。有履约评价为差的记录则该项不得分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

投标书目录

- 投标函
- 履约承诺函
- 诚信承诺函
- 供应商情况介绍
- 免费保修期内售后服务条款偏离表
- 免费保修期外售后服务条款偏离表
- 其他商务条款偏离表
- 疫情防控
- 技术规格偏离表
- 投标人认为需要加以说明的其他内容

2017 年医用设备购置项目东院区妇科设备 P

招标文件信息

项目编号： GMDL2020166100

项目名称： 2017 年医用设备购置项目东院区妇科
设备 P

包 号： A

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法（新价格分算法）

资格性审查表

| 序号 | 内容 |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》"投标人资格要求"）； |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质。 |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
|----|-------------------------------------------|
| 1 | 出现将一个包或一个标段中的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一货物投标时，提供两套或以上的投标方案(招标文件规定允许有替代方案情况除外)； |

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 投标总价或分项报价超出财政预算限额的； |
| 4 | 同一项目出现两个或以上报价，且根据招标文件通用条款“34.2 算术错误将按以下方法更正”内容，无法确定有效报价的； |
| 5 | 未按招标文件附件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件（投标文件组成不完整）； |
| 6 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据招标文件注明的不允许偏离的实质性要求和条件来做出评判）； |
| 7 | 投标文件载明的交货期未满足招标文件规定的期限； |
| 8 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的； |
| 9 | 《技术规格偏离表》、《免费保修期内售后服务条款偏离表》、《免费保修期外售后服务条款偏离表》和《其他商务条款偏离表》填写不全、不实； |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目，或投标报价对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 11 | 投标文件电子文档有病毒； |
| 12 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的； |
| 13 | 选择了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密； |
| 14 | 在同一 IP 地址上传电子投标文件的（由市、各区政府采购中心或中国远东国际招标有限公司为投标人提供辅助上传产生同一 IP 地址的情形除外）； |
| 15 | 法律、法规规定的其他情形。 |

评标信息

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 | 权重(%) |
|----|-----|-------|
| 1 | 价格 | 30 |

| | | | | |
|---|------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| 2 | 商务部分 | | | 20 |
| | | | | |
| | 序号 | 评分因素 | 权重 (%) | 评分准则 |
| | 1 | 免费保修期内售后服务条款 偏离情况 | 5 | 评审标准：（1）投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。满足免费保修期的得 30 %，每增加一年加 10 %，最高得 60 %；（2）其他要求全部满足要求的得 40%，每负偏离一项扣 10%，扣完为止，可有正偏离但不加分。 |
| | 2 | 免费保修期外售后服务条款 偏离情况 | 8 | 评审标准：（1）投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣 10%，最多扣 50%，可有正偏离但不加分；（2）投标人应填写价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细，以《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单》为准，各投标人的此项得分按以下公式计算：得分=价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的最低报价/投标人价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的报价×50%。（说明：本评分项总分 100%，以上两项分别占 50 %。） |
| | 3 | 其他商务条款偏离情况 | 2 | 评审标准： 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足或优于要求的得 100%，每负偏离一项扣 10%。 |
| | 4 | 疫情防控 | 5 | ①投标人纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业(以下简称“重点保障企业”)，直接参与我市政府采购投标的，投标人提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接或名单网页截图或政府部门出具的文件或企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件）扫描件，得 60%；②投标人未裁员或裁员率低于 20%，即 2020 年 3 月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的视为稳岗企业；投标人提供自身符合稳岗企业条件的承诺函（承诺函格式详见招标文件第三章），得 4 |

| | | | | |
|---|------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 0%；投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。 |
| 3 | 技术部分 | | | 43 |
| | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
| | 1 | 技术参数响应情况 | 40 | 评审标准： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行评分，全部满足或优于各项技术参数指标及要求的得 100%，带▲的重要参数条款每负偏离一项扣 10%，其他技术要求每负偏离一项扣 5%，扣完为止，最低 0 分。 |
| | 2 | 技术保障措施 | 3 | 评审标准：在投标文件中详细说明技术保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员等），评审委员会根据响应情况进行评分： 横向比较，技术团队规模和人员充足，技术方案完整详细，具有针对性、可行性、实操性，技术人员的素质高，得 100%；技术团队规模和人员较充足，技术人员素质较高，技术方案结构具体，实施适宜，有较强的条理性，得 80%。技术团队规模和人员基本满足项目需求，技术人员素质一般，技术方案制定完整，具有条理性，部分符合需求书内容，得 60%；技术团队规模和人员不足，技术人员素质较差，技术方案制定内容不完整，得 40%。 |
| 4 | 诚信部分 | | | 7 |
| | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
| | 1 | 诚信管理情况 | 5 | 评审标准：根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42 号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
| | 2 | 履约 | 2 | 评审标准：近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心无履约评价为差的记录， |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|
| | | | | 本项得 100%。有履约评价为差的记录则该项不得分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|

投标书目录

- 法定代表人证明书
- 授权委托书
- 投标函
- 履约承诺函
- 诚信承诺函
- 供应商情况介绍
- 免费保修期内售后服务条款偏离表
- 免费保修期外售后服务条款偏离表
- 其他商务条款偏离表
- 疫情防控
- 技术规格偏离表
- 投标人认为需要加以说明的其他内容

2017年医用设备购置项目 东院区妇科设备P

招 标 文 件

（项目编号：GMDL2020166100）



采购人：中国科学院大学深圳医院（光明）

采购代理机构：中国远东国际招标有限公司

2020年

2020 年警示条款

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

目录

招标文件信息

第一册专用条款

第一章招标公告

第二章用户需求书

第三章投标文件的格式、附件

第四章政府采购合同的签订、履约及验收

第二册通用条款

第一章总则

第二章招标文件

第三章投标文件的编制

第四章投标文件的递交

第五章开标与评标

第六章定标及公示

第七章公开招标失败的后续处理

第八章授予合同

第九章质疑处理

第十章招标代理服务费

备注：专用条款与通用条款内容有冲突的，以专用条款为准

第一册 专用条款

第一章 招标公告

文件编码：0722-206FE1033SZF

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定，中国远东国际招标有限公司就“2017年医用设备购置项目东院区妇科设备P”项目，采用公开招标的方式，欢迎各潜在供应商参加投标。

1. 项目名称（项目编号）：2017年医用设备购置项目东院区妇科设备P（GMDL2020166100）

2. 项目基本情况：

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 采购预算金额（万元） |
|-----------------------|----|----|------------|
| 2017年医用设备购置项目东院区妇科设备P | 项 | 1 | 225 |

3. 标书获得方法：

凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于2020年5月11日17:00至2020年5月19日17:00期间从光明区公共资源交易中心网(<http://gm.szzfcg.cn>)下载本项目的招标文件，并进行投标响应。潜在供应商登记注册手续详见深圳市政府采购网(<http://www.szzfcg.cn>)。潜在供应商如确定参加投标，首先须在深圳市光明区公共资源交易中心网上报名投标，方法为登录深圳市光明区公共资源交易中心网后点击“应标管理→投标响应”或“应标管理→确认邀请函”；如果网上报名后又不参加投标登录采购系统点击“撤销响应”。如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳政府采购网站，先办理注册手续，再进行投标报名。在网上报名后，点击“应标管理→下载招标文件”进行招标文件的下载。

4. 投标人资格要求：

1) 投标人须为深圳市政府采购中心的注册供应商且在光明区公共资源交易网上响应投标；

2) 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查；

3) 投标人参与本项目投标前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况（提供“诚信承诺函”，诚信承诺函格式详见招标文件“投标文件的格式、附件”）；

4) 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由供应商在“诚信承诺函”中作出声明，提供“诚信承诺函”，诚信承诺函格式详见招标文件“投标文件的格式、附件”）；

5) 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》扫描件，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》扫

描件（或《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件），且经营范围包含该产品；原件备查，未按要求提供或提供资料不清晰导致专家无法判断的可能作为投标无效处理；

6) 投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件扫描件）；原件备查，未按要求提供或提供资料不清晰导致专家无法判断的可能作为投标无效处理；

7) 根据《光明区财政局关于采购进口医用设备的复函》（深光财函〔2019〕535号）及《光明区财政局关于购置中国科学院大学深圳医院（光明）两院区进口医用设备项目（2017年）的复函》（深光财函〔2020〕33号）批示，本项目允许进口产品投标，但不排斥国内产品参与竞争；

8) 若所投产品为进口，则投标人提供由产品生产厂家或授权的中国总代理签署的合法有效的授权、保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供；

9) 深圳市海派投资咨询有限公司为本项目采购人提供前期设计、规划论证等服务，不得再参与此次采购项目的投标；

10) 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5. 答疑事项：

供应商如对本项目招标文件有任何疑问，包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款等，2020年5月17日17:00前将登录光明区公共资源交易中心网，在“应标管理→项目答疑发布”中填写相关疑问，逾期将不予受理。投标截止前集中将答疑结果及相关补充公告以网上公告方式或在采购系统中直接答复各投标人，请及时关注。

6. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，具体操作为登录“光明区公共资源交易中心网”，用“应标管理→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为100MB，超过此容量的文件将被拒绝。

7. 踏勘现场： 无

8. 投标截止时间：2020年5月22日14:30（北京时间）

9. 开标时间和地点：定于2020年5月22日14:30（北京时间）在中国远东国际招标有限公司开标室公开开标，供应商可以登录“光明区公共资源交易中心网”，用“采购项目查询及管理→查看开标一览表”功能点查询开标情况。

10. 中国远东国际招标有限公司有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。

11. 本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间，投标人有义务在招标活动期间浏览深圳政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）、光明区公共资源交易中心网（<http://gm.szzfcg.cn>）和中国远东国际招标有限公司网（www.zgyd11.com），在以上3个网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

12. 公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

13. 联系方式：

（1）招标组织机构

单位名称：中国远东国际招标有限公司

详细地址：深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22B

联系人：郜工、凌工

邮政编码：518034

联系方式：0755-82078919、82077364 转 108

传真电话：0755-82077519、82078847

邮 箱： info@zgyd11.com、dept1@zgyd11.com

网上操作咨询：0755-83004312 转 101（若下载招标文件有困难，请与我们联系）

（2）采购人

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

详细地址：中国科学院大学深圳医院西院区（上石家路马田街道综合(职业)康复服务中心旁边隆记猪脚饭店二楼 201）

项目联系人：张老师

联系方式：27165666-81916

中国远东国际招标有限公司

2020 年 5 月 11 日

第二章 用户需求书

说明:

1、本招标项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性,投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准,但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

2、标注“▲”的条款为重点审查的要求,作为评分参考的标记,但不作为实质性要求和条件。

标注“★”的条款为不允许偏离的实质性要求和条件,不符合将视为不实质性满足招标文件要求,作投标无效处理;未标注“★”的条款不作为实质性要求和条件。

3、投标人应根据本企业的成本自行决定报价,但不得以低于其企业成本的报价投标:

①投标人报价明显低于成本或其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评审委员会应当要求其对成本构成进行介绍,并要求投标人用书面的形式进行报价合理性说明(在保证质量的前提下,能够大幅节省经费的手段或原因);

②未做出报价合理性说明的,评审委员会认定为该报价低于成本价,并按投标无效处理;

③供应商的报价说明是否合理,由评审委员会判定;

④如该报价成为中标价格,该项目将成为重点监管、重点验收项目。

⑤若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明,以及书面说明是否采纳等判断不一致的,按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。

4、关于进口产品

①注明“接受进口”的产品(产品名称)允许供应商选用进口产品参与投标,但不排斥国内产品,即使在进口产品中,优先采购向我国企业转让技术,与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。采购进口产品的,必须先经区财政局审批同意。

②未注明“接受进口”的产品(产品名称)均不接受供应商选用进口产品参与投标。

③进口产品系指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品的定义以财政部《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248号)的相关规定为准。

5、关于相同品牌产品

使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人在评审委员会监督下采取随机抽签方式(按照招标文件第二册通用条款 18.1 规定的抽取程序)确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,根据招标文件载明的核心产品进行处理。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。

6、本项目由采购人授权评审委员会确定中标供应商,中标供应商数量为 1。

7、评标优惠政策:

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素(如鼓励创新等)需一并列出。

一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
|----|----------|--------------------------|
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120 日历天(从投标截止之日算起) |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |

| | | |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网上投标,投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前登录“光明区公共资源交易中心网”,用“应标管理->上传投标文件”功能将编制好的电子投标文件上传,投标文件大小不得超过 100MB。 |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注: 本表为通用条款相关内容的补充和明确, 如与通用条款相冲突的以本表为准。

二、项目基本信息

| | |
|------|------------------------------|
| 项目编号 | GMDL2020166100 |
| 项目名称 | 2017 年医用设备购置项目东院区妇科设备 P |
| 预算金额 | 225 万元 (超出预算金额的报价将被当作无效投标处理) |

开标一览表“交货期”

(1) 国产设备建议填写“合同签订后 30 日历日内”;

(2) 进口设备建议填写“合同签订后 90 日历日内”。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 是否核心产品 | 单位 | 数量 | 预算单价 (万元) | 备注 (是否允许进口等) |
|----|--------------|--------|----|----|-----------|--------------|
| 1 | (去内膜) 射频治疗系统 | 否 | 台 | 1 | 90 | 接受进口 |
| 2 | 光电一体电子阴道镜 | 否 | 台 | 1 | 35 | 接受进口 |
| 3 | 全高清宫腔镜冷切手术系统 | 是 | 台 | 1 | 100 | 接受进口 |

备注:

1、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标; 注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标。

2、进口产品系指: 通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3、“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、本项目的核心产品明确为“全高清宫腔镜冷切手术系统”。如出现多家投标人提供的核心产品品牌相同的情况, 将由评审委员会根据财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条的规定进行处理。

5、报价不得超出财政预算限额, 否则导致投标无效。

四、项目技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (去内膜)射频治疗系统 | <p>一、整体要求：</p> <p>▲1、该设备有国外F D A认证和C E认证；</p> <p>2、该设备具有单双极功能、大血管闭合钳、大血管闭合离断刀、双极精细电凝电切剪、盐水下双极等离子电切功能；能进行氩气刀、水刀、抽吸冲洗模块等功能升级；</p> <p>▲3、盐水下双极等离子功能可以与奥林巴斯、storz、狼牌等电切镜兼容通配使用；</p> <p>4、设备能满足医院妇科（含外科）的各种开放、腔镜手术；</p> <p>5、整机微电脑控制，中文彩色液晶触摸操作界面；</p> <p>6、设备模块化设计，器械能够自动识别，即插即用，操作简单；</p> <p>7、具有程序存储功能，可存储≥198 个程序；</p> <p>8、具有 NESSY 中性电极安全系统；</p> <p>▲9、具有功率峰值系统（PPS）支持初始切割；</p> <p>10、具有自动电切 AUTO CUT 功能，根据组织变化，功率输出自动调节。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、主机部分：</p> <p>1.1 电切输出功率：1-300W；</p> <p>1.2 电凝输出功率：1-200W；</p> <p>1.3 负极板安全系统：具有中性负极板安全系统；</p> <p>1.4 工作频率输出：≤350KHZ；</p> <p>1.5 电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%；</p> <p>1.6 电源频率：50/60HZ；</p> <p>1.7 最大输出时功率：500W/920VA；</p> <p>1.8 接地：提供标准接地装置；</p> <p>1.9 保险丝：T8A/4A；</p> <p>1.10 质量标准：CE 认证等保证质量；</p> <p>1.11 电切：具备三种以上的单极电切模式，各模式下具备八档的效果调节。具备三种双级电切功能；并可通过升级实现六种单极电切模式、四种双极电切模式；</p> <p>1.12 电凝：具备五种以上单极电凝模式，各模式下具备多指八档效果调节。具备四种以上双极电凝模式，带有效果调节。可自动启动及脚踏启动，具备自动停止输出功能。并可通过升级实现七种单极电凝模式、五种双极电凝模式。</p> <p>2、双极电切电凝剪器械（含开放及腔镜器械）</p> <p>2.1 器械可高温、高压消毒重复使用；</p> <p>2.2 腔镜器械由剪芯、套管、手柄、连线组成,如有损坏可独立更换每个配件；</p> <p>2.3 能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能。</p> <p>3、大血管闭合钳（含开放及腔镜器械）</p> <p>▲3.1 可以直接闭合最大至 7MM 的血管，有 FDA 和 SADA 认证（提供证书复印件），保证闭合的安全；</p> <p>3.2 开放用大血管闭合钳根据长度和弯度的不同提供至少 8 种型号供选择，提供可 360° 旋转手柄；</p> <p>3.3 腔镜用大血管闭合钳提供马里兰型（带防滑纹和不带防滑</p> |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|---------|-----|-------------|------|----------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|--------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| | | <p>纹)和开窗型(带防滑纹和不带防滑纹)至少 4 种型号供选择;</p> <p>3.4 腔镜用大血管闭合钳由钳芯、套管、手柄(带连线)组成;</p> <p>3.5 具有闭合智能化自动提示功能,血管闭合完毕自动停止输出;</p> <p>3.6 具有一次性及可高温、高压消毒重复使用配件;</p> <p>4、大血管闭合闭合离断刀(含开放及腔镜器械)</p> <p>4.1 器械自动识别,即插即用。</p> <p>▲4.2 提供有三种规格型号,分别是开放手术(200mm +/-5%轴长),腔镜手术(350mm+/-5%轴长),加长腔镜(肥胖病人)(450mm+/-5%轴长)。</p> <p>4.3 器械旋转: 340-360 度,有锁推刀的限位锁。</p> <p>4.4 器械头端π 型陶瓷头设计,血管闭合和离断同步进行。</p> <p>4.5 器械头端闭合离断距离长≤18mm,缩短手术时间。</p> <p>4.6 器械启动时,可以直接通过脚踏开关或者手柄启动。</p> <p>三、配置要求:</p> <table><tr><td>1. 主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2、负极板</td><td>50 片</td></tr><tr><td>3、负极板连线</td><td>1 根</td></tr><tr><td>4、一次性双按钮电刀笔</td><td>10 支</td></tr><tr><td>5、盐水下双极等离子连接电缆</td><td>1 根</td></tr><tr><td>6、阴式用大血管闭合钳</td><td>1 把</td></tr><tr><td>7、带遥控功能双脚踏控制系统</td><td>1 个</td></tr><tr><td>8、大血管闭合多功能系统软件</td><td>1 套</td></tr><tr><td>9、腔镜大血管闭合钳钳芯</td><td>1 支</td></tr><tr><td>10、腔镜大血管闭合钳套管</td><td>1 支</td></tr><tr><td>11、腔镜大血管闭合钳手柄</td><td>1 把</td></tr><tr><td>12、腔镜双极精细电切电凝剪系统软件</td><td>1 套</td></tr><tr><td>13、腔镜双极精细电切电凝剪剪芯</td><td>1 支</td></tr><tr><td>14、腔镜双极精细电切电凝剪套管</td><td>1 支</td></tr><tr><td>15、腔镜双极精细电切电凝剪外壳</td><td>1 支</td></tr><tr><td>16、腔镜双极精细电切电凝剪手柄</td><td>1 把</td></tr><tr><td>17、腔镜双极精细电切电凝剪连线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>18、大血管闭合闭合离断刀</td><td>2 把</td></tr><tr><td>19、台车</td><td>1 辆</td></tr></table> | 1. 主机 | 1 台 | 2、负极板 | 50 片 | 3、负极板连线 | 1 根 | 4、一次性双按钮电刀笔 | 10 支 | 5、盐水下双极等离子连接电缆 | 1 根 | 6、阴式用大血管闭合钳 | 1 把 | 7、带遥控功能双脚踏控制系统 | 1 个 | 8、大血管闭合多功能系统软件 | 1 套 | 9、腔镜大血管闭合钳钳芯 | 1 支 | 10、腔镜大血管闭合钳套管 | 1 支 | 11、腔镜大血管闭合钳手柄 | 1 把 | 12、腔镜双极精细电切电凝剪系统软件 | 1 套 | 13、腔镜双极精细电切电凝剪剪芯 | 1 支 | 14、腔镜双极精细电切电凝剪套管 | 1 支 | 15、腔镜双极精细电切电凝剪外壳 | 1 支 | 16、腔镜双极精细电切电凝剪手柄 | 1 把 | 17、腔镜双极精细电切电凝剪连线 | 1 条 | 18、大血管闭合闭合离断刀 | 2 把 | 19、台车 | 1 辆 |
| 1. 主机 | 1 台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、负极板 | 50 片 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、负极板连线 | 1 根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、一次性双按钮电刀笔 | 10 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、盐水下双极等离子连接电缆 | 1 根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、阴式用大血管闭合钳 | 1 把 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7、带遥控功能双脚踏控制系统 | 1 个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8、大血管闭合多功能系统软件 | 1 套 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9、腔镜大血管闭合钳钳芯 | 1 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10、腔镜大血管闭合钳套管 | 1 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11、腔镜大血管闭合钳手柄 | 1 把 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12、腔镜双极精细电切电凝剪系统软件 | 1 套 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13、腔镜双极精细电切电凝剪剪芯 | 1 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14、腔镜双极精细电切电凝剪套管 | 1 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15、腔镜双极精细电切电凝剪外壳 | 1 支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16、腔镜双极精细电切电凝剪手柄 | 1 把 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17、腔镜双极精细电切电凝剪连线 | 1 条 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18、大血管闭合闭合离断刀 | 2 把 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19、台车 | 1 辆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 光电一体电子阴道镜 | <p>一、技术参数及要求 :</p> <p>1、总体要求:显微阴道镜,具有光学镜头,整套设备为同一厂家生产;</p> <p>★2、放大倍数: 3.75~25 倍之间,具有国际金标准 15 倍光学放大,最小倍数小于 7 倍,可以观察到完整宫颈;</p> <p>3、变 倍 比: ≥4: 1;</p> <p>▲4、平行光无限远光学设计,双通道目镜配合分光器可以实现摄像及教学目镜(助手镜)同步使用,适合教学医院会诊、教学、考核;</p> <p>▲5、观测系统: 人体工学观测系统,倾斜角 45 度;</p> <p>6、视野范围: 11mm-75mm 之间;</p> <p>7、工作距离: 230-330mm 之间;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>8、筒间距调节：50-100mm 之间；</p> <p>9、视力修正：调整范围+5 到-5 之间；</p> <p>10、调焦旋钮：通过旋转装置可实现物镜随动+10mm 到-10mm 之间范围内微动调焦；</p> <p>▲11、光源：LED 冷光源同轴照明系统，CFDA 注册证上注明具有光源，保证医用安全。同轴光照射系统，垂直照射病灶，无阴影产生。光斑范围$\geq 65\text{mm}$；省电，LED 灯珠寿命≥ 2 万小时；可调内置式绿色滤镜；</p> <p>12、强度：工作距离 300mm 处$\geq 30000\text{Lux}$；</p> <p>13、支架：可旋转的原厂支架系统，操作者一手完成上下左右前后操控，阻尼任意调整，可以放在检查床左边或右边。支架可以真正以 $\geq 110\text{cm}$ 的半径自由水平移动；</p> <p>14、随动镜头水平云台：旋钮调节镜头水平云台，轻松实现镜头水平/垂直方向自由移动；</p> <p>15、中置手柄调节：可使镜头左右，上仰下倾随意调节。中置位置适合左右手不同习惯操作，适合手术中左右手灵活配合；</p> <p>16、像素 摄像系统：≥ 2400 万像素，支持超高像数图像采集，HDMI ($\geq 1920 \times 1080$) 高清实时图像显示，可选配接 4K 大屏幕同步显示，用于教学或多人观察，真正的镜下图像与显示器图像 100%同步显示；</p> <p>17、图像处理器：一体化主机，CPU， I5, 8G 内存，1000G 硬盘，≥ 21.5 寸高亮度液晶显示，相关软件及相关驱动程序。</p> <p>18、无缝缩放系统：无缝缩放技术，实现数字显微图像采集（采一张图像就可获得所有光学倍数下的高清图像），便于教学、会诊、永久保留光学连续变倍图像；</p> <p>19、彩色高清喷墨打印机支持无线连接，低耗材成本（可选激光彩色打印机/非无线）；</p> <p>20、软件管理系统：</p> <p>20.1 能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、储存、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。脚踏板、快捷键、鼠标点击多种控制采集方式；</p> <p>20.2 具有阴道镜血管分布增强显影处理功能，即对影像进行过滤变换处理，在滤除组织粘液同时，清晰显现毛细血管形态及收缩功能；</p> <p>20.3 提供对比分析，具备测量功能，如病灶周长、面积的参数，具备加注标识（如活检检查）和 RCI 评估功能、国际标准。提供年、季、月统计功能；</p> <p>▲20.4 可单幅、双幅、四幅、六幅、九幅以及纯文字彩色图像的中文病历报告打印；</p> <p>20.5 临床表现、临床处理、诊断意见等提供标准术语库、用户可进行修改；</p> <p>20.6 保持原图效果无压缩技术，真实还原保持医学影像权威，最大可保存 20 万幅以上，每次连续采集 1-100 幅；</p> <p>20.7 支持 1080P 原始高清动态实时图像&声音硬盘录像，实时回放检查过程；</p> <p>20.8 检查图像自带检查时间、医院名称等多项可选；</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|---------|-----|----------------|-----|-----------|-----|
| | | <p>20.9 具有醋酸实验时间提示，独特的三键脚踏开关，实现检查操作过程彩图、醋酸计时、报告格式转换无需动手控制；</p> <p>▲20.10 具有独特的多维画中画操作技术，双人配合操作，可以做到临床检查、实时观察、醋酸及碘试验并采集图像的同时，可以同步书写报告内容，加快工作进度，减少患者排队时间，减轻医生工作强度。</p> <p>20.11 具有国家卫健委两癌筛查标准报告模式，三阶梯标准报告；</p> <p>20.12 所有病历报告可以任意导出并保存在指定文件夹并刻盘；</p> <p>20.13 不同的病种以不同的查询术语标记，方便查询和统计。可统计医生工作量，生成报表并转化成 Excel；</p> <p>20.14 获得欧洲 CE 认证, 通过了 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。以及 Roch 环保认证；</p> <p>20.15 网络连接系统: 实现阴道镜检查数据和图像的应用层传输。</p> <p>21、原厂原装产品。</p> <p>二、配置清单：</p> <table><tr><td>1、主机</td><td>1 套</td></tr><tr><td>2、光源</td><td>1 台</td></tr><tr><td>3、信息工作站</td><td>1 套</td></tr><tr><td>4、2420 万像素单反相机</td><td>1 部</td></tr><tr><td>5、高清喷墨打印机</td><td>1 台</td></tr></table> | 1、主机 | 1 套 | 2、光源 | 1 台 | 3、信息工作站 | 1 套 | 4、2420 万像素单反相机 | 1 部 | 5、高清喷墨打印机 | 1 台 |
| 1、主机 | 1 套 | | | | | | | | | | | |
| 2、光源 | 1 台 | | | | | | | | | | | |
| 3、信息工作站 | 1 套 | | | | | | | | | | | |
| 4、2420 万像素单反相机 | 1 部 | | | | | | | | | | | |
| 5、高清喷墨打印机 | 1 台 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 全高清宫腔镜冷切手术系统 | <p>（一）、宫内刨削系统专用宫腔镜：一根</p> <p>1. ▲HOPKINS II 柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面；</p> <p>2. 平行目镜，标准目镜接口；</p> <p>3. 视向角 6°，视场角大于等于 90°；</p> <p>4. LUER 灌流接口；</p> <p>5. 至少 4.5mm 橄榄型器械通道，带阀门开关；</p> <p>6. 双路灌流系统；</p> <p>7. 双路照明系统；</p> <p>8. ▲可高温高压消毒。</p> <p>（二）、镜鞘：一套</p> <p>1. 360° 旋转；</p> <p>2. 配套专用无损伤钝头闭孔器；</p> <p>3. ▲直径小于等于 24Fr；</p> <p>4. 带 LUER 接口；</p> <p>5. 镜鞘表面带厘米刻度；</p> <p>6. 可高温高压消毒。</p> <p>（三）、剪刀：一把</p> <p>1. 可旋转，可拆卸，绝缘，带单极电凝连接头；</p> <p>2. 带 LUER 锁清洁灌流连接口，双动钳头，带锯齿，弯曲，圆锥形；</p> <p>3. 尺寸≤3 mm，长度≥36 cm。</p> <p>（四）、宫颈活检抓钳：一把</p> <p>1. 可旋转，可拆卸，绝缘，带单极电凝连接头，带 LUER 锁清</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>洁灌流连接口，双动钳头；</p> <p>2. 尺寸≤ 3 mm，长度≥ 36 cm。</p> <p>（五）、“鳄鱼嘴状”钳：一把</p> <p>1. 规格≤ 3 mm，双动钳夹。</p> <p>（六）、刨削切割手柄：一套</p> <p>1. 人体工程学设计；</p> <p>2. 大于等于 3 种个性化设置握持方式；</p> <p>3. ▲中央直排吸引通道；</p> <p>4. 往复切割模式；</p> <p>5. 切割速率大于等于 5000 次/分；</p> <p>6. 便捷锁扣，360° 安装；</p> <p>7. ▲可高温高压消毒。</p> <p>（七）、刨削刀头：一套</p> <p>1. 钝性无创头端；</p> <p>2. 卵圆形. 长方形两款开口，往复切割工作；</p> <p>3. 直径小于等于 4mm，长度大于等于 32cm；</p> <p>4. ▲切割方向可 360° 旋转；</p> <p>5. 配备定位器，与切割窗口方向一致；</p> <p>6. 含内. 外切割刀管，可拆卸，360° 安装；</p> <p>7. ▲可重复使用，高温高压消毒。</p> <p>（八）、宫内刨削动力主机：一套</p> <p>1. 自动识别器械，即插即用；</p> <p>2. 可手动设置最高限速；</p> <p>3. 液晶屏同时显示最高转速与实际转速；</p> <p>4. 脚踏控制，无级变速；</p> <p>5. ▲最高转速大于等于 40000 转/分；</p> <p>6. 兼容妇科动力产品大于等于 2 种；</p> <p>7. 可与至少 1 款冲洗吸引泵产品实现双机联动；</p> <p>8. 防水面板可擦拭消毒；</p> <p>9. 兼容一体化手术室。</p> <p>（九）、滚轮泵（抽吸吸引泵）：一套</p> <p>1. 高功率滚轮泵；</p> <p>2. 最高流速大于等于 1000 毫升/分；</p> <p>3. 手动. 自动两种模式；</p> <p>4. ▲可与妇科动力主机实现双机联动；</p> <p>5. 可用于宫腔镜下吸引，腹腔镜下冲洗或吸引；</p> <p>6. 配备冲洗管路及吸引管路，可高温高压消毒；</p> <p>7. 防水面板可擦拭消毒；</p> <p>8. 兼容一体化手术室。</p> <p>（十）、冲洗吸引泵（膨宫泵）：一套</p> <p>1. 流量范围：宫腔镜模式 0-500ml/min；腹腔镜模式 0-1000ml/min；</p> <p>2. 压力范围：宫腔镜模式 0-200mmHg；腹腔镜模式 0-400mmHg；</p> <p>3. 负压吸引范围：宫腔镜模式 0-（-0.5bar）；腹腔镜模式 0-（-0.8bar）；</p> <p>4. 安全等级：I 级；</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5. 有微电脑测压系统，可避免子宫穿孔的危险； 6. 智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制； 7. 可动态显示各种功能数据（如实际流量、实际压力等），操作便捷； 8. 电子控制系统可保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态； 9. 具有防止 TURP 综合症的负压系统； 10. 具有腹腔镜和宫腔镜两种工作模式； 11. 预设置与实际值同时显示，方便观察； 12. 可同时悬挂 2 袋液体，方便术中更换； 13. 兼容一体化手术室。 14. 配置清单 14.1 6° 广角柱状晶体镜 1 根 14.2 鞘芯 1 根 14.3 操作鞘（不大于 24Fr 直径） 1 个 14.4 剪刀 1 把 14.5 宫颈活检抓钳 1 把 14.6 “鳄鱼嘴状”钳 1 把 14.7 细纤维导光束 1 条 14.8 密封帽 1 包 14.9 刨削切割手柄 1 个 14.10 手柄把手 1 个 14.11 刨削刀 A 型 1 把 14.12 刨削刀 B 型 1 把 14.13 宫内刨削动力主机 1 台 14.14 连接线 1 条 14.15 滚轮泵（抽吸吸引泵） 1 台 14.16 冲洗吸引泵（膨宫泵） 1 台 14.17 冲洗吸引管 1 条 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

五、项目商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （一）免费保修期内售后服务要求 | | |
| 1 | 维修及维护服务 | 1.1 各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限 |
| | | 1.2 提供整机质保期 1 年，整机免费保修期 2 年，终身维修。保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次，保证运行状态稳定，每件设备必须提供消耗品（耗材等）优惠价格清单，否则视为免费。免费保修期内，投标人负责派技术人员免费维修更换相关机器零配件、免工时费，并承担修理、更换的相关费用；如无法维修，由投标人免费调换新的机器设备并承担相关运输费用及运输风险或退货产生的相关费用。免费保修期内，用户只承担更换零备件的费用（每件设备必须提供常规易损零备件的优惠价格清单，否则视为免费）。 |
| | | 1.3 设备出现故障由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位 |

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>(不可抗力情况除外)。消耗品和零配件供应及时, 特殊情况下可提供备用机。</p> <p>1.4 中标人负责货物的终身维修, 保证 8 年以上供应维修配件, 终身内免费提供软件升级服务。免费 2 年提供设备校准、合格证明。无间歇的远程网络服务支持; 提供技术咨询。</p> |
| 2 | 质量保证 | <p>2.1 在保修期内, 投标人应确保年开机率在 95% 以上, 若不能达到此开机率, 将作以下处理: a. 年开机率在 90-95% 之间按一赔 1.5 延长保修期; b. 年开机率在 85-90% 之间按一赔 2 延长保修期; c. 年开机率低于 85%, 投标人必须无条件更换新机, 并重新计算保修期, 以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注: 年开机率= (365-停机天数) /365)</p> <p>2.2 在质保期内, 供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品, 经维修多次还不能正常使用的, 需更换一台同型号的设备; 保修期后, 供应商应按其在本地区同类产品的优惠价格提供保修服务。</p> |
| (二) 免费保修期外售后服务要求 | | |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | <p>1.1 设备出现故障由设备制造商提供售后服务, 4 小时内响应, 24 小时维修到位(不可抗力情况除外)。消耗品和零配件供应及时, 特殊情况下可提供备用机。</p> <p>1.2 免费保修期满后, 中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中。</p> <p>1.3 采购人可与投标人就优惠价进行谈判, 但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。</p> <p>1.4 设备制造商维修的货物经采购人验收合格, 且设备制造商提供维修专用发票后, 采购人支付维修费用。</p> <p>1.5 供应商及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修, 不得要求采购人购买所谓“保修服务”(即: 不论设备有无故障先买保修服务), 不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。</p> |
| (三) 其他商务要求 | | |
| 1 | 报价要求 | 1.1 投标总价(人民币)须是完成该项目的一切费用总和, 包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费、招标代理费等全部费用。 |
| 2 | 交货要求 | <p>2.1 交货期是合同签订之日起至货物运抵采购单位指定地点并且完成安装、调试, 验收合格交付使用的时间期限。国产设备合同签订后 30 日历日内交货, 进口设备合同签订后 90 日历日内交货。</p> <p>2.2 中标人应提供货物的技术文件, 包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册(含维修密码及接口数据)、质量保证文件、服务指南、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明等, 所有外文资料须提供中文译本。上述技术文件应随货物一并交付至采购人指定地点。如不能提供维修资料, 保修期在原基础上延长 6 个月。</p> <p>2.3 提供的货物必须满足招标文件及技术参数要求, 为全新、经检验合格的产品(包括零部件)。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中, 进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。上述文件应随货物一并交付至采购人指定地点。投标人在投标文件所承诺的仪器功能, 所需的硬件和软件必须配置齐全。货物到达后, 投标人应向采购人提供全套的设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书及其它的技术资料。</p> |
| 3 | 运输、安装和 | 3.1 供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点, 并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等 |

| | | |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 验收 | 费用。（设备运送产生的风险由中标人负责）货物到达前一日中标方通知采购人，采购人同意后再按时送货。 |
| | | 3.2 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 3 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 |
| | | 3.3 中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 10 天内安装调试完毕。 |
| | | 3.4 由中标人代表和甲方科室和医学装备部代表三方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 4 | 培训 | 4.1 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定操作人员进行定期培训及指导，培训需有书面记录，作为验收依据之一。 |
| | | 4.2 并对本院维修工程师进行维护、维修培训，要有书面记录；直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 5 | 知识产权 | 5.1 投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。供应商保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
| | | 5.2 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 6 | 付款方式 | 6.1 完成安装、调试、培训、验收合格后，90 天内支付首付款(中标价格的 85%)；1 年后(以安装验收报告日期为准)支付质保金（中标价格的 15%）。 |
| 7 | 违约责任 | 7.1 如如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出质保金，采购人有权依法终止合同。 |
| | | 7.2 投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之二十（千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
| | | 7.3 投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之二十（千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
| | | 7.4 投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之二十（千分之十以上千分之二十以下）的违约金。投标人超过交货期限 15 日仍未交货，采购人有权依法解除合同。 |
| | | 7.5 由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的千分之五或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |
| | | 7.6 违约金先从由投标人质保金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 8 | 其他 | 8.1 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

| | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>8.2 备品配件：</p> <p>1) 在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。</p> <p>2) 质保期满以后，供应商应按其在本地同类产品的优惠价格提供保修服务。</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

政策导向

1、按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》、《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》及《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》，详见中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）。

2、2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用 LNG 或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用 LNG 或电动工程机械、装卸机械的比例不低于 30%。

3、根据《光明新区管委会落实〈2018 年“深圳蓝”可持续行动〉工作目标责任书》“强化机动车排气污染防治力度”要求，“对外包环卫清扫和清运标段，推广纯电动环卫车。2018 年 5 月 1 日起，对重新招标标段所使用的环卫车，4.5 吨及以下的全部更换为纯电动环卫车，4.5 吨以上的不少于 30% 更换为纯电动环卫车”；

根据《光明新区发展和财政局转发推广纯电动环卫车应用有关要求的通知》（深光发财〔2018〕609 号）以及《深圳市城市管理局关于加快推进使用纯电动环卫车的通知》（深城管通〔2018〕292 号）的要求，“各区需完成推广纯电动环卫车，以及柴油环卫车 DPF 安装改造或提前淘汰工作，2018 年 5 月起，各区对重新招标标段所使用的环卫车，除垃圾清运类勾臂车外的全部车辆更换为纯电动车”；

对重新招标的环卫作业服务招标文件，必须同时满足以上两点关于更换纯电动车的要求，如有矛盾或者不一致的，按最严格的要求执行。

4、根据《光明新区环境保护和水务局关于落实〈低挥发性有机物含量涂料技术规范〉有关要求的通知》“限制高挥发性有机物含量产品参与招标采购”要求，确保符合《低挥发性有机物含量涂料技术规范（SZJG 54-2017）》，要求区各级政府部门采购项目中必须采购使用低挥发性有机物含量涂料生产的办公家具。

第三章 投标文件的格式、附件

特别提醒：投标人在编制投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，投标人应自行承担不利后果。

一、法定代表人证明书（上传至附件）

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件。

注：必须提供法定代表人（负责人）有效期内身份证（正反面）扫描件（非中国境内居民，可提供公安部门认可的身份证明材料），否则将导致投标无效。

二、授权委托书

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的（姓名）（身份证号码：）代表我单位签署（项目名称）的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认；

被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而消失；被授权人无转委托。

被授权人：性别：年龄：

联系电话：手机：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证扫描件。

注：须提供被授权人有效期内身份证（正反面）扫描件。

投标人确保被授权人的联系方式正确，并保证在项目开评标过程中及项目履约期间保持电话、手机畅通。如因投标人自身原因导致无法联系的情况，投标人应自行承担不利后果。

三、投标函

致：中国远东国际招标有限公司

1、根据贵司组织实施 _____ 项目（项目编号：_____）的招标文件，遵守《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目。

2、投标人将按招投标文件的规定履行合同权利和义务。

3、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我单位如有幸中标，我方将受此约束。

4、我单位已认真详细阅读招标文件内容，在投标截止时间后，放弃提出对招标文件误解及质疑投诉的权利。

5、如我单位有幸中标，中标通知书和本投标文件将作为本项目采购合同的附件约束我单位。

6、我单位愿意向贵司及采购人提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：

地址：

电话/手机：

传真：

邮箱：

财务负责人/企业负责人的联系方式：_____（可选填项，需向金融机构申请订单融资的，以便金融机构提供更精准的融资服务）

投标人单位名称：

日期： 年 月 日

注：

1、该联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件文书送达。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

2、为缓解中小企业融资难题，我市推出政府采购订单融资改革举措。订单融资具体流程及试点金融机构订单融资服务承诺可参阅深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目或深圳政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）政府采购订单融资栏目。

四、履约承诺函

致：中国远东国际招标有限公司

我单位承诺：

1. 对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权，我单位已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

2. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购法律法规，投标做到诚实，不串标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，且会被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予禁止参与政府采购活动或其他处罚。

3. 我单位已认真核对了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

4. 我单位承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

5. 如我单位有幸中标，做到守信，依照本项目招标文件及投标文件要求、与采购单位签署的采购合同，以及本公司在投标中所作的一切承诺进行履约。

6. 我单位已认真阅读本项目需求，特别是交货期、完工期和服务期的要求，我司承诺完全满足本项目的交货期、完工期和服务期要求。

7. 我单位承诺不转包或非法分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

投标人单位名称：

年 月 日

五、诚信承诺函

致：中国远东国际招标有限公司

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目投标前三年内，无行贿犯罪记录。

2. 我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况

5. 除以上条件，我单位参与本项目政府采购活动时，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他的条件。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并自愿承担投标无效的后果以及赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

投标人单位名称：

年 月 日

六、分项报价清单（上传至附件）

（一）项目报价表

投标人名称：

被授权人：

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-------|------|-------|-----|----|----|----|-----------|-----------|----|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 投标总价 | | | | | | | | | |

注：1、投标人填写本表应当包括但不限于以上内容；

- 2、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
- 3、投标总价应为以上各分项价格之和；
- 4、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地；

（二）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细须填写于此清单中。

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|-------|------|-------|-----|----|----|-----------|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
|-------|--------|------|-------|
| 1 | 延续保修合同 | | |
| | | | |

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

注：格式参照《（一）项目报价表》表格，但须提供相应的品牌、规格型号、原产地、单价等详细信息。

七、供应商情况介绍

1. 投标人情况介绍：

2. 资格证明材料：

投标人须按招标文件中“投标人资质要求”提供相关的资质证明，投标文件中未提供或提供不完整、不符合要求的，将按投标无效处理。在政府采购系统响应报名的单位，不代表资格审查通过。

3. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函：

（备注：该部分内容由供应商根据自身情况提供相关内容，不符合要求的供应商不提供。）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（请填写：采购单位名称）单位的_____（请填写：采购项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位名称：
日期：

(二) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（请填写：采购单位名称）单位的_____（请填写：采购项目名称）项目采购活动，并提供：_____（请填写：“本单位制造的货物”或“由本单位承担的工程、提供服务”或“提供其他残疾福利单位制造的货物”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位名称：
日期：

(三) 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____（请填写：采购单位名称）单位的_____（请填写：采购项目名称）项目采购活动，并提供：_____（请填写：“本单位制造的货物”或“由本单位承担的工程、提供服务”或“其他监狱企业制造的货物”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人单位名称：
日期：

八、免费保修期内售后服务条款偏离表

投标人名称：
项目编号：
包号：

| 序号 | 项目类别 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填写说明：
1.请投标人于“投标响应”栏中对招标要求中相关条款作出响应情况详细描述；“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“无偏离”，优于要求的填“正偏离”。未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

九、免费保修期外售后服务条款偏离表

投标人名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目类别 | 招标规格 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填写说明：

1.请投标人于“**投标响应**”栏中对**招标要求**中相关条款作出响应情况详细描述；“**偏离情况**”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“无偏离”，优于要求的填“正偏离”。
未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

十、其他商务条款偏离表

投标人名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目类别 | 招标规格 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填写说明：

1.请投标人于“**投标响应**”栏中对**招标要求**中相关条款作出响应情况详细描述；“**偏离情况**”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“无偏离”，优于要求的填“正偏离”。
未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

十一、疫情防控

①纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业的证明材料

②稳岗企业承诺函

致：中国远东国际招标有限公司

我单位参加贵司组织的政府采购项目，我单位承诺投标前一个月（即 2020 年 3 月）实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）。

我单位对上述声明内容的真实性负责，并接受和配合采购单位的核查。如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。

投标单位：

年 月 日

(特别说明：投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。)

十二、技术规格偏离表

投标人名称:

项目编号:

包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
|----|------|--------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填写说明:

1. 请投标人于“**投标响应**”栏中对**招标要求**中相关条款作出响应情况详细描述;“**偏离情况**”栏中根据响应情况填写,没有达到要求的填“**负偏离**”,达到要求的填“**无偏离**”,优于要求的填“**正偏离**”。
2. 投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料,以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等, **相关证明资料可提供在本节点中。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的,投标人可以不提供。**
3. 证明资料(扫描件)的提供要求(如招标文件要求提供响应证明资料):
 - a 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页;提供外文说明书或彩页的,必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准,外文说明书或彩页仅供参考;产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;
 - b 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容;产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

十三、技术保障措施(上传至附件)

十四、投标人认为需要加以说明的其他内容(格式自拟)

医学装备采购 合 同 书

项目编码：

合同编号：

项目名称：

签约单位：

签约时间： 年 月 日

签约地址：中国科学院大学深圳医院（光明）

XX 项目购销合同

甲方：中国科学院大学深圳医院（光明）

乙方：

甲、乙双方根据____年__月__日中国科学院大学深圳医院（光明）院内招标采购项目（项目编号：_____项目名称：_____）的中标结果和“招标文件”的要求以及对采购科室的确认，经甲、乙双方协调一致，达成如下合同：

一、设备名称：

| 设备名称 | 产地品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|-------|
| | | | | | | |
| 合同总价（小写）：¥ （大写：人民币 圆整） | | | | | | |

本合同以人民币进行结算，该价格为深圳工地价（含税）。

二、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。若乙方提供进口设备，则须提供合法的进口手续和商检证明。

2、免费保修期内售后服务要求：乙方承诺对本项目拟采购设备的整机（包括但不限于主机、配件和易耗品等）提供免费维修保养期____年（保修期为甲方验收整机合格之日起算），终身维修。保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于____次。保修期内，乙方负责派技术人员免费维修更换相关机器零配件、免工时费，并承担修理、更换的相关费用；如无法维修，由乙方免费调换新的机器设备并承担相关运输费用及运输风险或退货产生的相关费用。

依招投标文件约定，设备制造商提供售后服务，____小时内响应，____小时维修到位（不可抗力情况除外）。设备必需消耗品和零配件应供应及时，特殊情况下可提供备用机。乙方负责货物的终身维修，保证____年以上供应维修配件，____年内免费提供软件升级。

在保修期内乙方应确保年开机率在 95%以上，若不能达到此开机率，将作以下处理：

a. 年开机率在 90-95%之间按一赔____延长免费保修期；

b. 年开机率在 85-90%之间按一赔____延长免费保修期；

c. 年开机率低于 85%，乙方必须无条件更换新机，并重新计算免费保修期，以及赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。

3、免费保修期外售后服务要求:设备制造商提供售后服务, _____小时内响应, 小时维修到位(不可抗力情况除外)。消耗品和零配件供应及时, 特殊情况下可提供备用机。

保修期满后, 乙方应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

甲方可与乙方就零配件、消耗品和延续保修合同优惠价进行谈判, 但优惠价不得高于乙方在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

乙方及设备制造商或授权委托代理商维修的货物经甲方验收合格, 且乙方及设备制造商或授权委托代理商提供维修费用及配件发票后, 甲方支付维修费用。

乙方及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修, 不得要求甲方购买所谓“保修服务”(即: 不论设备有无故障先买保修服务), 不得在设备中嵌设任何不利于甲方使用与维修设备的障碍。

三、交货时间、地点、方式:

合同签订生效后____天内, 乙方负责将设备运抵甲方指定的地点, 由甲方相关科室负责验收。

四、运输、安装和验收方式:

1、乙方负责将货物安全无损运抵甲方指定地点, 并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。(设备运送产生的风险由乙方负责)

2、甲方有权检验或测试货物, 以确认货物是否符合合同规格的要求, 并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等, 甲方可以拒绝接收该货物, 乙方应在____天内采取补足、更换或退货等措施, 以满足规格的要求, 由此发生的一切损失和费用由乙方承担。

3、乙方负责货物的现场安装和调试, 提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。乙方应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试, 并在____天内安装调试完毕。

4、由乙方代表和甲方组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告。乙方应按要求组织现场培训, 并出具培训报告, 产品保修期自验收报告签署之日起算。

五、其他商务条款

1、培训：乙方应派专业技术人员免费对甲方指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

2、知识产权：乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与甲方无关。否则，乙方应全额赔偿甲方因此遭受的经济损失(包括但不限于因此造成的律师费、诉讼费、检测费及其他因此造成的损失等)。

甲方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

3、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关资料。

六、付款方式：

根据深圳市光明新区财政部门有关规定以及本合同的约定，完成安装、调试、培训及验收合格后，乙方提供合格付款资料 90 天内支付首付款（合同总价的 85%）；1 年后经审计合格，支付剩余款项（合同总价的 15%）。

七、违约责任：

1、如乙方未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，乙方应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿甲方因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，甲方有权终止合同。

2、乙方所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付项目采购金额千分之二十的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚，同时甲方有权解除合同。

3、乙方不能交付设备的，乙方向甲方偿付合同总价金额千分之二十的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期未交设备的，乙方向甲方每日偿付合同总价千分之二十的违约金。乙方超过交货期限7日仍未交货，甲方有权解除合同。

5、乙方如违反本合同第二条中第 2 项及第 3 项售后服务要求，乙方向甲方偿付合同总价金额千分之二十的违约金。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得相关权威部门出具的不可抗力证明或双方谅解

解确认后，允许重新协商变更或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

十、其他

1、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效，均具同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同附件是本合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

附件：

1、中标通知书

2、产品技术参数及配置清单

| | |
|----------------------------|--------|
| 甲方：中国科学院大学深圳医院（光明） | 乙方： |
| 地址：深圳市光明新区马田街道松白路 | 地址： |
| 4253 号 4221 号和光明街道华夏路 39 号 | |
| 法定代表人： | 法定代表人： |

| | |
|--------|--------|
| 委托代理人： | 委托代理人： |
|--------|--------|

| | |
|------------------------|-----------|
| 电话： 0755-27166086 | 电话： |
| 开户银行：工商银行深圳公明支行 | 开户银行： |
| 帐号：4000027809024901348 | 帐号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 12440300MB2C78267B | |

二、政府采购履约情况反馈表

采购单位名称：

联系人及电话：

| | | | | |
|----------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | 项目编号 | |
| 中标供应商名称 | | | 供应商 联系人及电话 | |
| 中标金额 | | | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 | | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| | 分项评价 | 质量方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| | | 价格方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| | | 服务方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| | | 时间方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| | | 环境保护 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| | | 其他 | 评价内容为： _____ 评价等级为： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| 具体情况说明 | | | | |
| 采购单位意见 (公章) | | 日期： 年 月 日 | | |

说明：

- 1、本表为采购单位向深圳市光明区公共资源交易中心反映政府采购项目履约情况时所用；
- 2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况；
- 3、在政府采购项目合同履约过程或履约结束后 30 日内，采购单位应当及时填写本表以书面形式对采购实施流程中标供应商（含预选供应商）所提供的产品、服务或工程的质量、价格和履行情况进行反馈，作为该供应商诚信管理的重要参考，未按要求书面反馈中标供应商的履约情况的，视为对供应

商的履约情况无意见。

4、采购单位可通过书面或政府采购系统提交此表。

第二册 通用条款（公开招标）

第一章 总则

1.通用条款说明

政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出光明区政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以随这些条款增加附录或补充内容。

2. 招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的规定，并参考有关法规、政策、规章、规定通过招标择优选定供应商。

3.采购单位、政府集中采购机构、投标人

3.1“政府集中采购机构”系指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构；本项目系指中国远东国际招标有限公司；

3.2“采购人”或“采购单位”：系指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.3“投标人”或“投标方”，即供应商，是指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”和“谈判小组”是依据《深圳经济特区政府采购条例》有关规定组建的专门负责本次评标（谈判）工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳市政府采购网提供的投标书加密软件加密的投标文件,适用于网上投标；（此投标书加密软件可从 www.cgzx.sz.gov.cn 网站“相关软件”栏目中下载）；

3.8“网上投标”指通过深圳市政府采购网上传电子投标文件；

3.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人在政府采购项目投标过程中应当遵循诚实守信、公平竞争的原则，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将按无效处理，该供应商将被列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

5.合格的投标人

5.1 在中华人民共和国境内（不含享有独立关税地位的地区）注册，并有能力按本次招标文件的要求提供本项目相关货物、工程和服务。

5.2 遵守并符合《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》的有关规定。

5.3 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标机构的投标人。

5.4 在深圳市政府采购中心注册的政府采购供应商。

5.5 采购项目不接受联合投标（招标文件中有特殊要求除外）。

5.6 参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”的内容。

6. 联合体投标

6.1以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

6.2由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共

同投标时，应符合以下原则：

(1) 投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 投标联合体各方必须有一方先行注册成深圳市政府采购中心供应商；

(3) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4) 是否允许联合体参加投标，应当由采购人根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示；

(5) 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，招标公告对投标人某一资格有要求的，按照联合体各方中最低资质等级确定联合体的资质等级；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，可以要求联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体各方的不同资质可优势互补；

(6) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

(7) 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

(8) 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任；

(9) 联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给政府集中采购机构；

(10) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有联合体、总包单位的投标将被拒绝；

(11) 除非另有规定或说明，本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方。

7.本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标文件有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口产品的定义以财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的相关规定为准。进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标文件有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及

类似的义务。

8.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府集中采购机构和采购单位均无义务和责任承担这些费用。

9. 踏勘现场

9.1 如有需要，政府集中采购机构或采购单位将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按**招标公告**所约定的时间、地点统一踏勘现场。

9.2 投标人及其人员经过采购单位的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3 采购单位必须通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.5 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

10. 招标答疑

10.1 招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

10.2 投标人提出的与投标有关的问题须在招标文件规定的答疑截止时间前以网上提问形式提交给集中采购机构。

10.3 政府集中采购机构对疑问所做出的澄清和解答，以书面答复（包括网站发布信息）为准。答疑纪要的有效性规定按照本通用条款第 **13.3**、**13.4** 款规定执行。

10.4 如政府集中采购机构认为有必要组织现场答疑会，投标人应按照招标文件规定的时间或集中采购机构另行书面通知（包括网站发布的通知）的时间和地点，参与现场答疑会。

10.5 未参与招标答疑不作为否定投标人资格的理由。

第二章 招标文件

11.招标文件构成

11.1 要求提供的货物、工程、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

关键信息

第一册 专用条款

第一章 招标公告

第二章 用户需求书

第三章 投标文件的格式、附件

第四章 政府采购合同的签订、履约及验收

第二册 通用条款

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标与评标

第六章 定标及公示

第七章 公开招标失败的后续处理

第八章 授予合同

第九章 质疑处理

专用条款与通用条款内容有冲突的，以专用条款为准。

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

11.3 网上报名。为方便开标准备工作，投标人如确定参加投标，应登录深圳政府采购网站网上报名参加投标，方法是点击“应标管理→投标响应”或“应标管理→确认邀请函”；如果网上报名后又不参加投标的，应再点击“撤销响应”。

11.4 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.招标文件的澄清

12.1 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，或要求澄清招标文件的，均应在招标公告规定的答疑截止时间内，按网上提问的形式向政府集中采购机构提交。不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括光明区公共资源交易网站公开发布方式）答复或发送给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

12.2 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

12.3 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13.招标文件的修改

13.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，政府集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

13.2 招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

13.4 政府集中采购机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

第三章 投标文件的编制

14.投标的语言及计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政府集中采购机构和采购单位就有关投标的所有来往通知、函件和投标文件均应使用中文书写。任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准，但翻译错误的除外。

14.2 除非技术规范另有规定，投标文件使用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件构成

15.1 投标人应按本招标文件规定的投标书目录提供招标要求的所有材料。

15.2 投标文件必须是通过在深圳市政府采购中心网站（www.szzfcg.cn）下载的最新版投标书编制软件制作的，并使用投标人密钥及正确加密规则加密成功的电子档文件（文件格式为 BIDX 文件）；投标人自行承担错误操作投标书编制软件或使用了旧版本的投标书编制软件制作投标文件使投标文件无法打开、资料缺失、无法显示等情况导致的扣分、投标无效等不良后果；不正确加密的投标文件将导致其投标被拒绝。

16.投标文件格式

16.1 投标人应按招标文件提供的“投标文件的格式”填写。

16.2 本招标文件中的“包”是最小的“标的单位”，投标人可对本“招标文件”中所列的所有货物、工程和服务项进行投标，投标人可只对其中一个包或几个包的内容进行投标（如有的话），但不得将一个包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

17.投标报价和货币

17.1 投标报价以人民币为结算单位。

17.2 国产的有关货物、工程和服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

17.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关工程、服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

17.4 投标人对项目的报价必须是唯一的，不接受有任何选择的报价。

18.投标人资格的证明文件

18.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

18.1.1 采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取 18.1.5 规定的随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

18.1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取 18.1.5 规定的随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.1.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.1.4 公开招标以外采购方式以及政府采购服务和工程涉及采购货物的项目，也按此方法计算供应商家数。

18.1.5 随机抽取程序：采购人代表从 01-50 号球中抽取一个球：抽到 01-25 号范围内的球，本项目由号码最小的投标人获得资格；抽到 26-50 号范围内的球，本项目由号码最大的投标人获得资格。各投标人按照投标时间依次抽签，如最大（小）出现两家或以上投标人同号的情况，则对同号的投标人重新摇签确定获得资格的投标人。抽签过程中遇抽签机器卡球的，被卡球方当轮重新抽签。

18.2 投标人除招标文件规定的资格条件外，还必须符合国家法规规定的强制性条件，并提供相关证明文件，作为投标文件的一部份。

18.3 投标人提交的证明文件应当是合法有效的。

18.4 投标人应提交参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺，并作为其投标文件的一部分。

19.证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

19.1 投标人应提交证明文件证明其投标技术方案项下的货物、工程或服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数

据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，以证明投标人响应的真实性。它包括并应符合以下要求：

19.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

19.2.2 投标产品从采购单位开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

19.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术规格已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。

19.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供扫描件，原件备查；

19.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供扫描件，原件备查。

19.3 未达到 19.2 要求提供的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

19.4 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的货物、工程或服务要求）或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分或作投标无效处理外，集中采购机构可视情况报政府采购监督管理部门作进一步处理。

19.5 投标人在阐述上述第 19.2 时应注意采购单位在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足采购文件中技术规格的要求，是否满足，由评审委员会来评判。

19.6 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一货物、工程或服务投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

20.投标文件其他证明文件的要求

20.1 对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况、银行资信等级和资金流状况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资质证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件，原件备查。有关扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以作投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。

20.2 本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未批准之前，仍按原级别资质投标。

21.投标有效期

21.1 在未有特别要求的情况下，投标有效期一律为 120 个日历日，投标应在规定的投标有效期内保持有效。投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效；

21.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府集中采购机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式（包括网站公开发布方式）提交。投标人可拒绝政府集中采购机构的这种要求，其投标在原投标有效期截止后不再有效；接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，但应当相应的延长投标担保有效期。

21.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

22.投标文件的制作要求

22.1 投标人应准备所投投标项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据招标人提供的后缀名为.zbs 的电子采购文件、《投标书编制软件》编制。（要下载安装《投标书编制软件》及其配套软件，可在深圳市政府采购网下载并安装最新版本的投标书编制软件，或在打开新版投标书编制软件时按自动升级提示要求安装投标书编制软件至最新版本，须先安装 Adobe Reader 9.0 以上。）**投标人应使用最新版本的投标书编制软件制作投标文件，因投标人未及时更新投标书编制软件造成投标文件出错（如：开标一览表空白，无法正常导入投标书浏览软件等）而导致投标无效的，后果由投标人自负。**

22.2 投标人在利用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

1、导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 A 包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目 B 包的投标书。

2、不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的用户登录上传本公司的投标文件。

3、要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

4、投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果杀毒软件报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

5、完整填写“投标关键信息”，如下图所示：



如果在投标文件的其它地方有与“投标关键信息”内容相冲突的，以“投标关键信息”为准。

6、投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致评审委员会对该投标文件作出不利判断或投标无效，一切后果由供应商自行承担。填写完投标文件后，要检查每一个章节中图片的清晰程度，如果图片中字体的笔划不连贯，难以辨识的，请及时更换，以确保图片清晰可辨，无法辨识的图片将可能导致评审委员会对该投标文件作出不利判断或投标无效。

7、投标书编写完成后，必须用属于本公司的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

8、中国远东国际招标有限公司不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标

文件，中国远东国际招标有限公司不负任何责任。**建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询（电话：0755-88212595）。**

9、如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，中国远东国际招标有限公司有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标供应商不得对此持有异议。

以上九条，如有违悖，中国远东国际招标有限公司将不接受该投标文件。

22.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

22.4 投标文件不用盖章或签字（招标文件另有特殊要求除外）。

22.5 资格证明文件按招标要求提供扫描件（招标文件另有特殊要求除外）。

23. 投标人的替代方案

23.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非招标的项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，投标无效。

23.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

第四章 投标文件的递交


24.投标文件的加密

24.1 在投标文件制作完成后，投标书编制软件自带的加密程序能自行对其进行加密，投标人无须用其它加密方式。此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，加密软件会提示选取对应项目的加密规则文件，**如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被中国远东国际招标有限公司拒绝。**选取项目加密规则文件的界面如下图所示：



(图 1：标书加密)

点击“开始”按钮进行标书加密，根据软件的提示信息完成标书的加密。

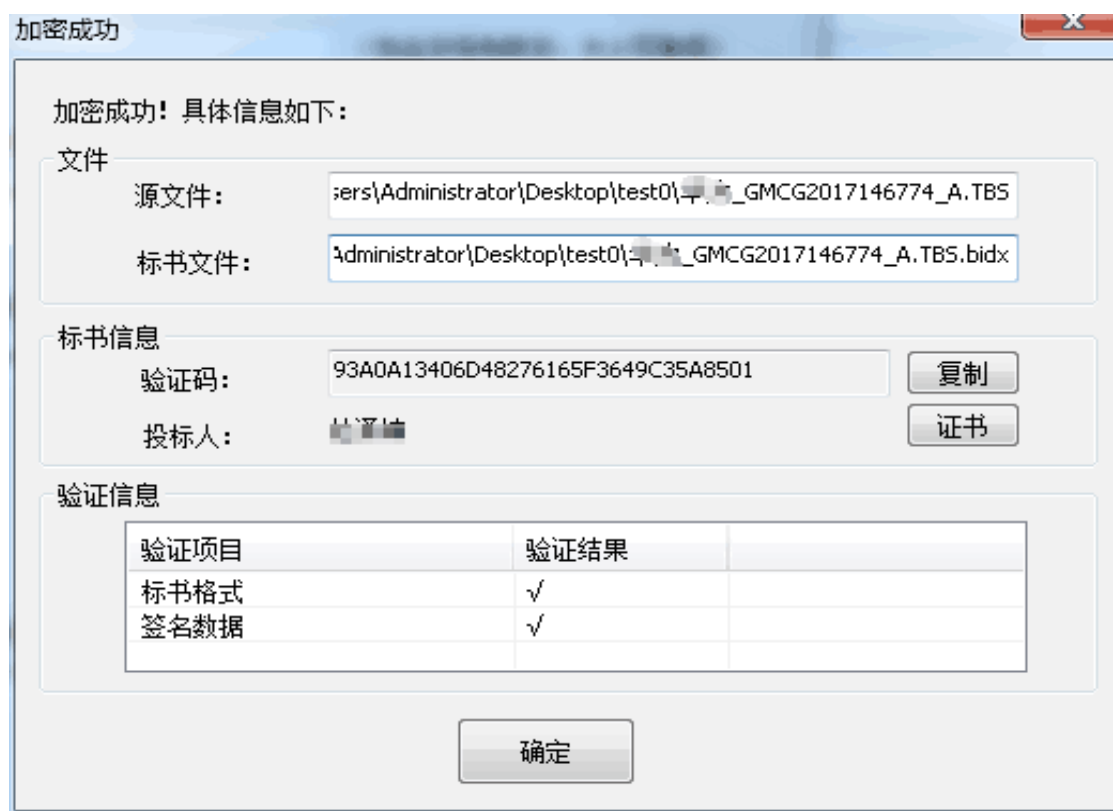

(图 2：标书加密成功)

24.2 若采购项目出现延期情况，投标人必须重新下载新的加密规则、重新上传投标文件。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25. 投标

25.1 网上投标

投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳市光明区公共资源交易中心”（gm.szzfcg.cn），用“应标管理”—》“上传投标文件”功能点上传投标文件。如果没有该功能点，请用本公司的机构管理员密钥在“系统维护”—》“修改用户权限”中增加该功能点，如果增加不成功，请在工作日与深圳市政府采购中心联系，联系电话：0755-83948155。如果确有困难，多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达深圳市光明区公共资源交易中心技术支持部门，联系电话：0755-88212595。

25.2 中国远东国际招标有限公司可以按通用条款第 13 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，中国远东国际招标有限公司、采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

26. 迟交的投标文件

26.1 投标截止时间以后不得上传投标文件。

27. 投标文件的修改与撤回

27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。

27.4 评审委员会不退还投标文件。

28. 样品的递交

28.1 原则上，不接受样品要求（如有要求，详见第一册专用条款的第二章相关内容）。如确有必要，采购人可以要求投标人提供能反映货物材质或关键部分的极少部分的尺寸、价值不大的样品，投

标人在投标时应提交《样品清单》，样品作为投标文件的一部分。

28.2 投标样品上必须标注“项目名称及项目编号、样品编号、样品名称”等信息，但不得显示指向任何投标供应商的信息、生产厂家的商标，或者其他的标记标识。需要安装的投标样品必须为安装完整的成品，由投标供应商自行组织安装。

28.2.1 样品递交签到：

投标供应商授权人要求在本项目投标截止时间前，携带法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人授权委托书（盖公章）、授权委托人身份证原件和复印件、样品清单（加盖公章），到达中国远东国际招标有限公司，按政府集中采购机构工作人员指引进行样品递交签到。

特别注意事项：（1）上述资料提供不齐全的，不予签到；（2）本项目投标截止时间后，不再受理签到；（3）未进行签到的，样品不予接收。

28.2.2 样品接收

本项目投标截止时间后进行投标样品接收。投标样品接收必须进行身份核对、样品核对、登记确认、顺序编号。

（1）身份核对。政府集中采购机构核对投标供应商授权委托人提供的“法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人授权委托书（盖公章）、授权委托人身份证原件和复印件”。资料不齐全的，不得接收投标样品。

（2）样品核对。政府集中采购机构工作人员将投标样品与投标供应商提供的《样品清单》（盖公章）进行一一核对。有不一致的或损坏情况的，将要求供应商授权委托人在《样品清单》上注明。

（3）登记确认。在完成身份核对及样品核对后，投标供应商授权委托人必须在《样品接收登记表》上登记确认。

（4）顺序编号。政府集中采购机构工作人员按投标样品接收的先后顺序进行编号。

28.3 政府集中采购机构工作人员负责组织投标样品摆样，指引供应商授权委托人将投标样品搬运到指定地点摆放、拆除包装，按要求摆放整齐。

28.4 样品的退回：投标样品移交时，政府集中采购机构工作人员将再次核对供应商授权委托人或采购人代表身份、核对《样品清单》，签字确认后并取走样品。

28.5 投标样品未能及时退回的，政府集中采购机构工作人员将及时存放到样品室，并发函或电话敦促相关单位取回。经敦促仍未能按规定取回的，视同投标供应商或采购人放弃取回，中国远东国际招标有限公司将定期清理。

第五章 开标与评标

29.开标

29.1 招标人根据采购文件规定的时间、地点对投标文件进行解密，开标，并在网上发布开标一览表。

29.2 按照第 26.1 条规定，在网上进行了“撤销响应”和“撤标”的操作的投标将不予开封。

29.3 进行网上投标，当招标人开标后，投标人即可登录“深圳市政府采购网”，用“采购项目查询及管理→查看开标一览表”功能查看开标一览表。

30.评审委员会

30.1 网上开标结束后召开评标会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评标活动。

评审委员会的组成及行为规范执行《深圳经济特区政府采购条例实施细则》，评审委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评审委员会成员由主管部门从深圳市财政委员会评标专家库中随机抽取。

采购单位代表持本单位签发的《评标授权书》及身份证明材料参加评标。

采购单位不派代表参与评标，应在开标前三天提交《采购单位不派评委参与项目评标承诺书》给政府集中采购机构。

30.2 评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

30.3 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

30.4 评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

30.5 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。

31.向评审委员会提供的资料

31.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

31.2 其他评标必须的资料。

31.3 评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

- (1) 招标的目的；
- (2) 招标项目需求的范围和性质；
- (3) 招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
- (5) 招标文件所列示的投标无效或废标条款。

32.独立评标

32.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

33.投标文件的澄清

33.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34.2条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

33.2 对于未按要求进行澄清的，视为投标人放弃澄清，并相应承担不利后果。

34.投标文件的初审

34.1 **投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。**资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

34.2**投标文件报价出现前后不一致、存在明显文字或计算错误的将按以下方法依序更正：**

34.2.1若开标一览表中报价与投标价格表中投标总价不一致，以开标一览表报价为准；

34.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

34.3 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件进行审查，内容详见《关键信息》→《资格性审查表》。评审委员会对投标单位打√为通过审查，打×为未通过审查。

34.4 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。内容详见《关键信息》→《符合性审查表》。评审委员会对投标单位打√为通过审查，打×为未通过审查。

34.5 投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

34.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

34.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

34.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

34.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

34.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

34.5.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

34.5.7 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

34.5.8 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

34.5.9 同一工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

34.5.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

34.6 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和 33.5 条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

34.7 政府集中采购机构在评标前，应当在深圳市政府采购网、深圳市政府采购监管网“诚信档案”栏目以及信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）集中查询投标供应商的诚信状况，并将供应商诚信状况提供给评审委员会，由评审委员会根据招标文件的规定进行评审。相关信用信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

35.投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

36.实地考察、演示或设备测试

36.1 在招标过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件。投标人应随时做好接受检查的准备。

36.2 若招标文件要求进行现场演示或设备测试的，投标人应做好相应准备。

37.评标方法（本项目具体所采用的评标方法详见《关键信息》→《评标信息》）

项目评标方法分为最低价法、综合评分法、定性评审法及法律、法规允许的其它评标办法。

37.1 最低价法

37.1.1 最低价法是指评审委员会按照以下方法对投标文件进行评审：完全满足招标文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；投标报价且技术指标相同的，则现场由采购人在开标现场随机抽取决定排名。（**随机抽取程序：**采购人代表从 01-50 号球中抽取一个球：抽到 01-25 号范围内的球，本项目由号码最小的投标人获得有利排名；抽到 26-50 号范围内的球，本项目由号码最大的投标人有利排名。各投标人按照投标时间依次抽签，如最大（小）出现两家或以上投标人同号的情况，则对同号的投标人重新摇签确定获得有利排名的投标人。抽签过程中遇抽签机器卡球的，被卡球当轮重新抽签。）

37.1.2 如评审委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供商未能提供合理说明的（是否合理由评审委员会判定），评审委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是低于成本，评委会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

37.2 综合评分法

37.2.1 综合评分法，是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高排列，报价最低者为中标候选供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术得分且投标报价相同的，则现场由采购人在开标现场抽签决定排名。（**随机抽取程序：**采购人代表从 01-50 号球中抽取一个球：抽到 01-25 号范围内的球，本项目由号码最小的投标人获得有利排名；抽到 26-50 号范围内的球，本项目由号码最大的投标人有利排名。各投标人按照投标时间依次抽签，如最大（小）出现两家或以上投标人同号的情况，则对同号的投标人重新摇签确定获得有利排名的投标人。抽签过程中遇抽签机器卡球的，被卡球当轮重新抽签。）

37.3 定性评审法

定性评审法是指评审委员会按照以下方法对投标文件进行评审：按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评审报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或无效标的投标人，均推荐为候选中标供应商。

37.4 本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

37.5 其它采购方式的采购程序

37.5.1 同一包号需多个供应商中标的情形

同一包号需多个中标供应商的，应在《专用条款》中作特别说明。评审委员会根据评标方法评审的结果从优到劣进行排序，并按招标文件规定的中标供应商数量择优推荐或确定中标供应商。

37.5.2 其它评标方法

采用上述评标方法以外的评标定标方法的，必须事先征得政府采购主管部门的批准，并在招标文件作特别说明。

38 资格后审

38.1 评审委员会保留审查中标供应商投标文件响应及承诺是否与实际一致的权利，包括对中标供应商投标的真实可靠性、规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如发现虚假投标或弄虚作假的，评审委员会将根据相关法律法规确定最终结果。

第六章 定标及公示

39. 定标方法

39.1 采购人授权评标委员确定中标供应商的，评审委员会依据本项目招标文件及通用条款 38 条所约定的评标方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定中标供应商；

39.2 采购人采用评定分离方法确定中标供应商的，评审委员会依据本项目招标文件及通用条款 38 条所约定的评标方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，推荐候选中标供应商；采购人根据招标文件专用条款明确的定标方法在候选中标供应商中确定中标供应商。

40. 编写评标报告

评标报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

41. 中标结果公示

41.1 评标定标结束后，政府集中采购机构和招标人将在“深圳市光明区公共资源交易中心”（gm.szzfcg.cn）上公布中标结果，公示期为三天。若投标人对中标结果有异议，投标人可以用书面形式向中国远东国际招标有限公司提出书面质疑，若中标结果公示之日起七个工作日内未提出质疑，则视为认同中标结果。

41.2 提出质疑的供应商应保证其质疑的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

第七章 公开招标失败的后续处理

42. 公开招标失败的处理

42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

(1) 由政府集中采购机构重新组织公开招标；

(2) 根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4 公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，政府集中采购机构要重新按公开招标流程发布招标公告和招标文件、组成评审委员会等组织采购活动。

42.5 公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

43. 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购

43.1 谈判应答文件

43.1.1 公开招标失败后，供应商的投标文件即转为谈判应答文件。

43.2 谈判小组

43.2.1 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共 3 人以上（含 3 人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

43.2.2 谈判前，谈判小组将对各供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按投标无效处理，不得进入谈判，具体内容见《资格性审查表》和《符合性审查表》。

43.3 谈判程序

43.3.1 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

43.3.2 在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

- (1) 投标价格；
- (2) 项目实施方案；
- (3) 售后服务方案；
- (4) 其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过政府集中采购机构通知所有参加谈判的供应商。

43.3.3 谈判小组可以用书面形式要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，供应商应主要以书面形式进行澄清、说明。

43.3.4 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，以及对项目方案进行相应的调整。

43.3.5 供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

43.3.6 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

43.3.7 有下列情形之一的，该供应商的谈判结果作投标无效处理，具体内容见《资格性审查表》和《符合性审查表》。

43.3.8 谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

43.3.9 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

43.4 评标方法和定标原则

43.4.1 根据《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》（深财购[2005]5 号），竞争性谈判采购项目的评标方法要比照**最低价法规定执行**。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报经同级政府采购监督管理部门批准。**原招标文件若采用最低价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法应采用最低价法。**

43.4.2 对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的投标价格、实施方案、售后服务等谈判结果并按通用条款第 36.1 规定的**最**

低价法进行评审。

43.4.3 若要采用其他评标方法的，必须报经政府采购监督管理部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。

43.4.4 谈判小组向政府集中采购机构提交书面评标报告，并受采购人授权直接确定中标供应商。

44. 公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

44.1 谈判小组

44.1.1 公开招标失败项目转为单一来源方式采购后，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共 3 人以上（含 3 人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

44.1.2 谈判前，谈判小组将对单一来源供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按投标无效处理，不得进入谈判，具体内容见《资格性审查表》和《符合性审查表》。

44.2 谈判程序

44.2.1 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

44.2.2 在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

- （1）项目方案；
- （2）报价；
- （3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过政府集中采购机构通知供应商。

44.2.3 谈判小组可以用书面形式要求供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，供应商应主要以书面形式进行澄清、说明。

44.2.4 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

44.2.5 供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

44.2.6 谈判小组与单一来源供应商进行谈判。供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

44.2.7 有下列情形之一的，供应商的谈判结果作投标无效处理，具体内容见《资格性审查表》和《符合性审查表》。

44.2.8 谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

44.2.9 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

44.3 评标方法和定标原则

44.3.1 **单一来源谈判采用最低价法。**原招标文件若采用最低价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法改为最低价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果按通用条款第 36.1 规定的**最低价法**进行评审。

44.3.2 谈判小组向政府集中采购机构提交书面评标报告，并受采购人授权直接确定中标供应商。

第八章 授予合同

45. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

45.1 政府集中采购机构和采购单位保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

46. 中标通知书

中国远东国际招标有限公司沿用深圳市政府采购中心数字中标（成交）通知书系统，于 2017 年 8 月 18 日启用。启用后，政府采购项目将全面实施网上打印数字中标（成交）通知书。

46.1 数字中标（成交）通知书相关操作流程见下述：

46.1.1 关于数字中标（成交）通知书的发放

系统上线后，各采购单位、中标供应商可在收到政府采购系统发送的短信通知后，使用数字证书登录网上政府采购统一平台，打印本单位参与项目的中标（成交）通知书（具体操作及通知书文本样式详见深圳市光明区公共资源交易中心网站数字中标（成交）通知书网上操作手册）。

46.1.2 关于数字中标（成交）通知书的验证方法

各采购单位、供应商可以通过扫描数字中标（成交）通知书上的二维码或点击中标（成交）通知书“有效性验证”链接两种方式进行验证。验证方式在每一份数字中标（成交）通知书上均有载明。

46.1.3 关于网上操作技术咨询

为确保数字中标（成交）通知书发放工作的顺利开展，如对数字中标通知书系统网上操作有疑问，可拨打中心技术支持服务电话咨询。联系电话：88212595。

46.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

46.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，中国远东国际招标有限公司有权撤销原中标通知书。

47. 签订合同

47.1“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

47.2 采购人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

47.3 采购人自政府采购合同签订之日起十日内，携带全套合同及中标（成交）通知书原件到光明区公共资源交易中心备案。如有另行签订补充合同的，采购人应在补充合同签订之日起十日内到光明区公共资源交易中心办理备案手续。采购人凭加盖“合同备案专用章”的合同、中标（成交）通知书及相关材料办理资金拨付手续。

47.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

48. 中标服务费

48.1 政府集中采购机构不收取中标服务费，报价时投标人应充分考虑这个因素。

49.履约情况的反馈

采购人应及时向政府集中采购机构反馈中标人的履约情况（填写《政府采购履约情况反馈表》），中标人的履约情况将作为供应商考核的重要依据。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报区采购主管部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

- a.名片、宣传册、广告标语等；
- b.案例介绍、推广等；
- c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商相关责任

51.1 若供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条规定情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。市、区财政部门将加大对违法违规供应商的惩戒力度，实施联合惩戒。

51.2 供应商违法责任

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

- （1）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （5）与其他采购参加人串通投标的；

- (6) 恶意投诉的;
- (7) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的;
- (8) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的;
- (9) 其他违反本条例规定的行为。

第九章 质疑处理

52. 质疑接收机构

52.1 涉及采购需求的询问与质疑事项,以及适用评定分离自定法定标的的结果选择问题,由采购人负责接收。涉及信息公开和评审过程等询问与质疑事项,由中国远东国际招标有限公司负责接收。

53. 质疑回复原则

53.1 质疑回复遵循公平、公正、规范、高效的原则。

53.2 供应商质疑实行实名制和“谁质疑, 谁举证”的原则, 质疑应有具体的事项及事实根据。

54. 质疑接收的时效和范围

54.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标(成交)结果使自己权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 按照光明区公共资源交易中心官网公布《政府采购供应商质疑函范本》填写(下载地址: <http://113.98.245.237:1019/bszn.do>), 以书面形式向中国远东国际招标有限公司提出质疑, 联系方式及地址详见招标公告。

54.2 供应商对采购文件有疑问的, 中国远东国际招标有限公司按答疑程序回复; 供应商对采购文件有异议的, 按质疑程序回复。

55. 质疑条件

55.1 提出质疑的应是直接参与相应采购项目的供应商。以联合体形式参与的, 由联合体的主体共同提出;

55.2 提供质疑的项目名称和编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况;

55.3 有质疑的具体事项、请求及理由, 并附相关证据材料及法律依据;

55.4 质疑书加盖公章, 被授权人进行质疑的同时提交营业执照复印件、法定代表人证明书及其身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件;

55.5 质疑材料中有外文资料的, 应一并附上中文译本, 并以中文译本为准。

不符合上述条件的, 供应商应当补正材料, 补正后中国远东国际招标有限公司予以接收。

56. 接收质疑程序

56.1 先与质疑供应商进行沟通, 以消除因误解或对采购规则和程序的不了解而引起的质疑。对沟通情况满意的, 供应商撤回质疑, 质疑程序终止。

56.2 处理质疑一般进行书面审查; 必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查; 组织原评审委员会或谈判小组进行复核。

56.3 在质疑处理期间, 原则上不中止采购活动。但深圳市光明区财政局可以视情形决定是否暂停采购活动。

56.4 中国远东国际招标有限公司原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。质疑事项需要向有关部门取得证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的, 所需时间不计入质疑处理期间。

质疑答复函以直接领取、传真或邮寄方式送达。

56.5 供应商向中国远东国际招标有限公司提出质疑后, 在质疑期限内, 不得同时向其他方面提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的, 质疑程序终止。

56.6 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

57. 质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的处理

57.1 根据《深圳市财政委员会关于执行财政部94号令质疑答复后续处理规定的意见》(深财购函〔2018〕3924号), 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的, 如果合格供应商符合法

定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的；如果合格供应商不符合法定数量，依法重新开展采购活动。

57.2 质疑答复导致中标、成交结果改变的，中国远东国际招标有限公司依法将有关情况向深圳市财政委员会书面报告。供应商对质疑处理结果不满，可依法向深圳市财政委员会提起投诉。

58. 相关责任与义务

58.1 采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合中国远东国际招标有限公司进行质疑处理，如实反映情况，及时提供证明材料。

58.2 质疑供应商有下列情形之一的，中国远东国际招标有限公司将视情节上报至政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门记入供应商诚信档案：

58.2.1 捏造事实或提供虚假证明材料的；

58.2.2 假冒他人名义进行质疑的；

58.2.3 拒不配合进行有关调查、情节严重的。

第十章 招标代理服务 fee

参照深圳市财政局《关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购(2018) 27 号）及附件计收。

按“《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》”文及附件计收。

注：

- 1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算；
- 2、本次招标为货物招标，招标代理（中标）服务费按货物招标计费标准收费，由中标人支付。
- 3、招标代理服务收费按差额定率累进法计算后下浮 20% 计取；
- 4、招标代理服务费用不足 3000 元的，按 3000 元收取。

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 各类型招标代理服务费计算费率 | | |
|--------------------|----------------|--------|--------|
| | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100 万元（含）-500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500 万元（含）-1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000 万元（含）-5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元（含）-1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1 亿元（含）-5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5 亿元（含）-10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10 亿元（含）-50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50 亿元（含）-100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

招标代理服务费缴纳至：

开户名称：中国远东国际招标有限公司深圳分公司

银行帐号：11013651025501

开户银行：平安银行深圳中电支行